


Pokyny ke správnému umístění manžety Orbit-K™


Krok 1

Palpací vyhledejte pažní tepnu mezi tricepsem a tricepsem.

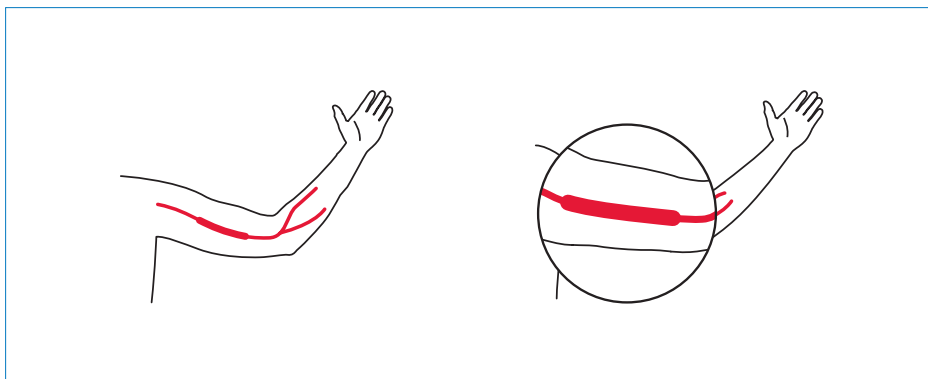


Krok 2

Zvolte vhodnou velikost manžety. Manžeta je na vnitřní i vnější straně vybavena značkami Range, které výběr usnadní.




Krok 3

Umístěte manžetu na paži. Dbejte, aby značka tepny (Artery) ukazovala po paži dolů a mikrofon byl na pažní tepnu, 3-5 cm od lokte.



Krok 4


Obtopte manžetu pevně kolem paže. Zápěstními páskami dodanými s přístrojem *Tango* M2 připevněte kabel pacienta a mikrofonu k zápěstí, jak je znázorněno dole.

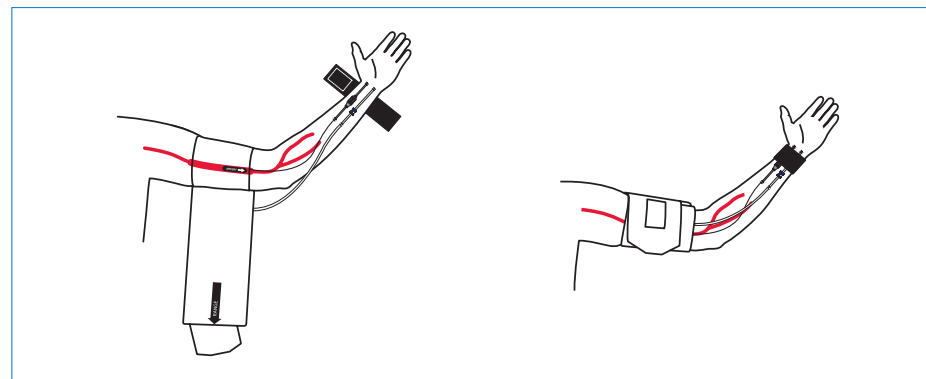

Pokyny ke správnému umístění jednorázové manžety


Krok 1

Zasuňte mikrofon do jeho návleku podle obrázku. Díky pilnavému povrchu z návleku nevyklouzne.




Krok 2

Sloupte ochranný kryt z návleku mikrofonu, jak je znázorněno dole.




Krok 3

Správné umístění mikrofonu je nutné pro přesnost výsledku. Umístěte mikrofon na pažní tepnu, mezi biceps a triceps (přibližně 2 prsty nad loketní jamku).




Krok 4

Vyberte jednorázovou manžetu *SunTech* vhodné velikosti. Manžeta je navržena na vnitřní i vnější straně - vybavena značkami Range, které výběr usnadní.




Krok 5

Obtočte manžetu pevně kolem paže. Značka tepny musí být na pažní tepně, jak je znázorněno dole.




Krok 6

Zapojte kabel mikrofonu do konektoru, jak je znázorněno dole. Směr zapojení konektoru není důležitý. Při bezpříčinném zapojení se ozve klapnutí.



Krok 7

Hadici k manžetě zapojte do konektoru na kabelu pacienta, jak je znázorněno dole.



Krok 8

Zápní pásky dodané s přístrojem *Tango M2* připevněte kabel pacienta a mikrofonu k pacientově zápěstí, jak je znázorněno dole.

